


Bestellformular - Flex BK - Transtibial


Umfang des Prothesenschafts am oberen Ende des Covers [mm]




Um das Umfangsmaß genau zu ermitteln, markieren Sie bitte genau das obere Ende des Covers. Bitte messen Sie sehr sorgfältig an der Markierung (siehe Bild). Ein abrutschen beim messen nach oben oder unten kann zu einer Änderung des Umfangs um mehrere Zentimeter zur Folge haben.




Höhe des Cover in [mm]



Wir messen vom niedrigstem Punkt des Fußes. Fall als Bild, der untere Teil kann bis zur Form der Fußkosmetik beschliffen werden



1

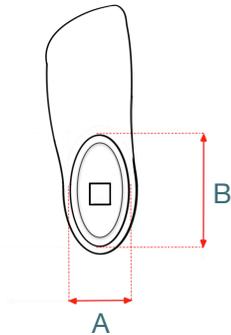

A [mm]

B [mm]

Fuß-Hersteller, Typ, Größe und Seite

Zum Beispiel: OB Taleo 1C50 L29

Adapter

30

34

z.B.:
4WR95=3

Neue Farben

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Geben Sie die Nummer ein:

- mattes Finish als Standard
- nicht für Tätowierungen verfügbar

Farbe

- Haut 1
- Haut 3
- Graphit
- Weiß
- Grau
- Schwarz
- Matter Lack (Extra Kosten)

Tattoo (Extra Kosten)

Nummer aus dem Katalog der Webiste

Zum Beispiel: 07-1001; eigen

Check Liste:


Foto der Fußkosmetik

Foto des Fußes aus einer Höhe von ca. 1 Meter. Der Fokus der Kamera ist hierbei auf den Pyramidenanschluss zu richten. Dies ist sehr wichtig!



4 Fotos von jeder Seite

Die Kamera muss vertikal und in einer niedrigen Position zum Bein und der Prothese sein


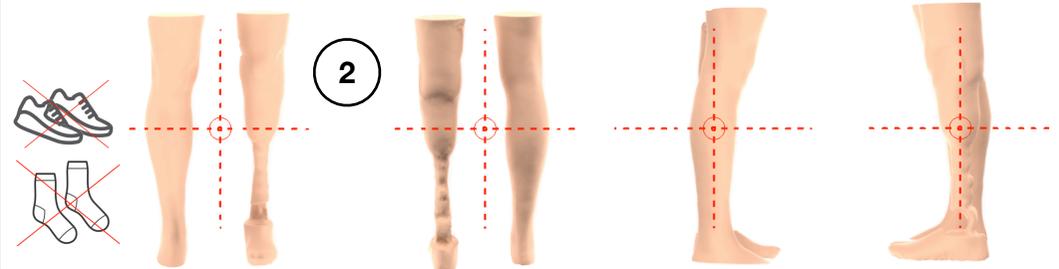


Scan der Prothese und des Beins

Die Scandateien müssen .stl / .obj sein.



Sehr wichtige Informationen – nicht senden.

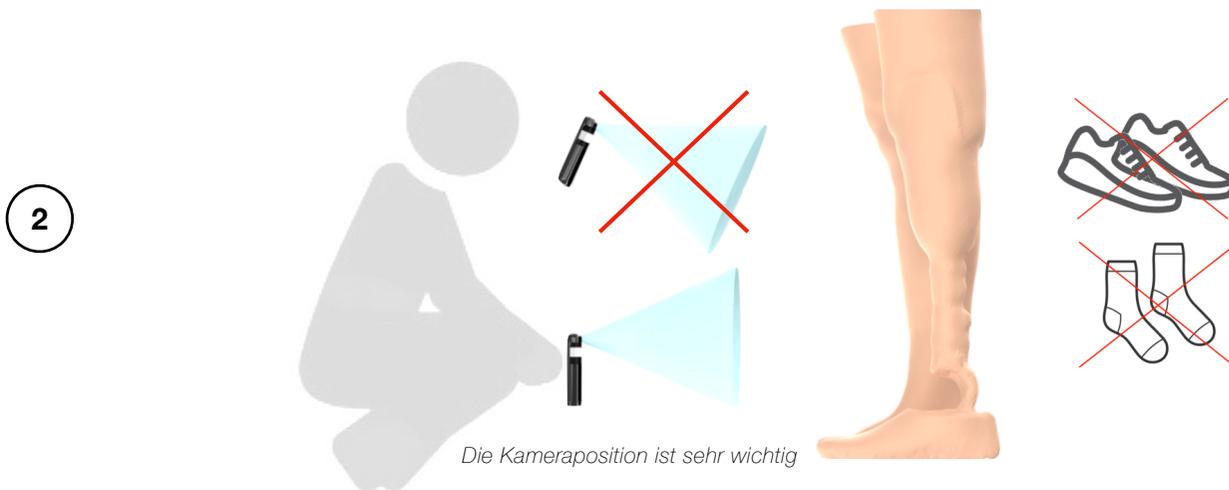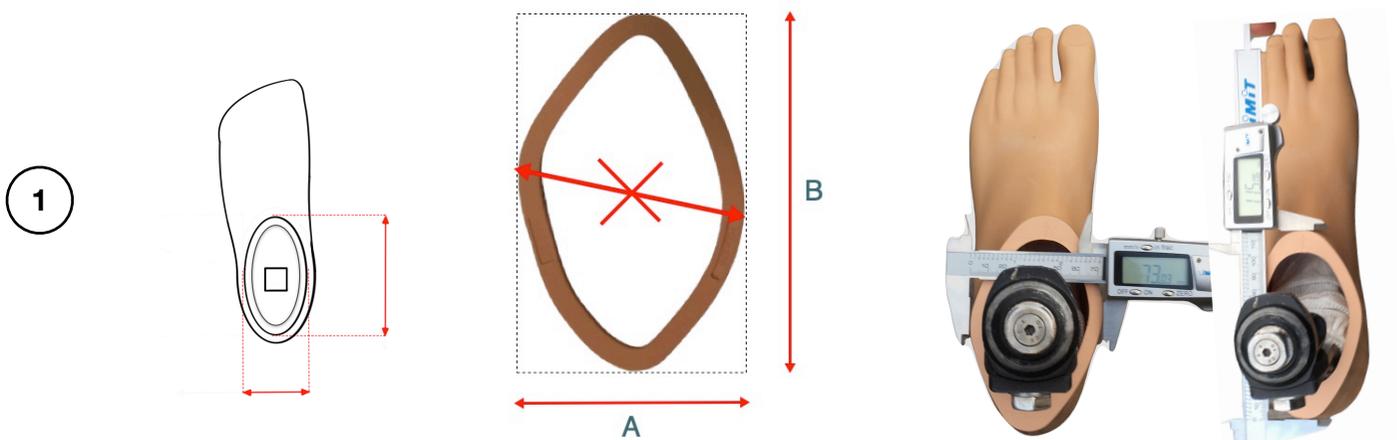

- Alle Cover von uns können vom distalen Ende aus um ein paar mm gekürzt werden.
- Im Auslieferungszustand ist das distale Ende des Covers flach.
- Bei einer geschwungenen Fußkosmetik kann der untere Teil des Covers an die Form des Fußes angepasst werden.