Hoja de pedido - **Flex Duo**

okm prosthetics

Circunferencia del encaje a la altura en [mm]

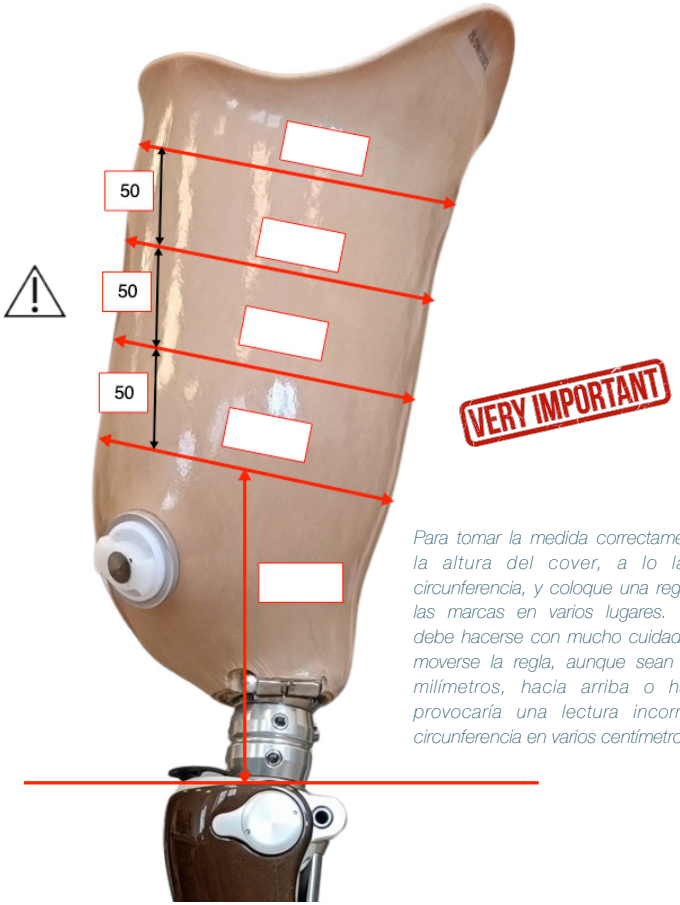

Para tomar la medida correctamente, marque la altura del cover, a lo largo de la circunferencia, y coloque una regla debajo de las marcas en varios lugares. La medición debe hacerse con mucho cuidado porque de moverse la regla, aunque sean unos pocos milímetros, hacia arriba o hacia abajo, provocaría una lectura incorrecta de la circunferencia en varios centímetros.

Tubo (mm)

Por encima de la rodilla

- ☐ 30
- ☐ 34

Por ejemplo : 4WR95=3

Nuevos colores

21	41	61	81
23	43	63	83
25	45	65	85

Introduzca el número:

- acabado mate de serie
- no disponible para tatuajes

Color

- ☐ Piel 1
- ☐ Piel 3
- ☐ Graphite
- ☐ Blanco
- ☐ Gris
- ☐ Negro
- ☐ Mate *(coste adicional)*

Tatuaje

Disponible solo para tono de Piel 3, color Blanco y Gris.

☐ Número del catálogo de la web de next: ej 07-1001

☐ Propio

Lista de verificación:

☐ Tome 4 fotos, *tal y como se muestra en las imágenes de arriba. La cámara debe colocarse perpendicular a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben estar centradas en la foto. Recuerde que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluido el encaje. Por favor, quite los zapatos, calcetines o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.*

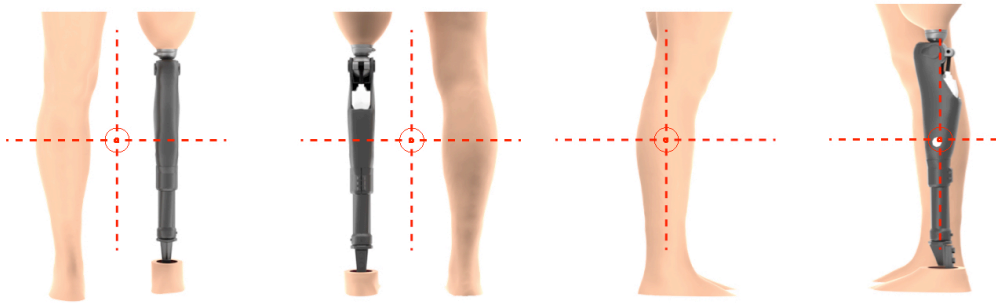



Format
.stl
.obj

☐ Dos escaners 3D:

1 - Paciente de cintura para abajo (con prótesis puesta)
2 - Prótesis (retirada del paciente)

Format
.stl
.obj

NOTAS :

- *Si el cover proporcionado no un agujero para la válvula y se necesita uno, este debe ser hecho.*
- *Después de colocar el Cover Duo la parte más baja debe estar aproximadamente 5-6cm por debajo de la rodilla protesica.*
- *Información detallada de la instalación puede ser encontrada en la página web y entregada junto al producto.*



okm@okm.es

NUEVOS COLORES: NO ENVIAR